


STOP！コロナ対策ステーション 設置イメージ上図

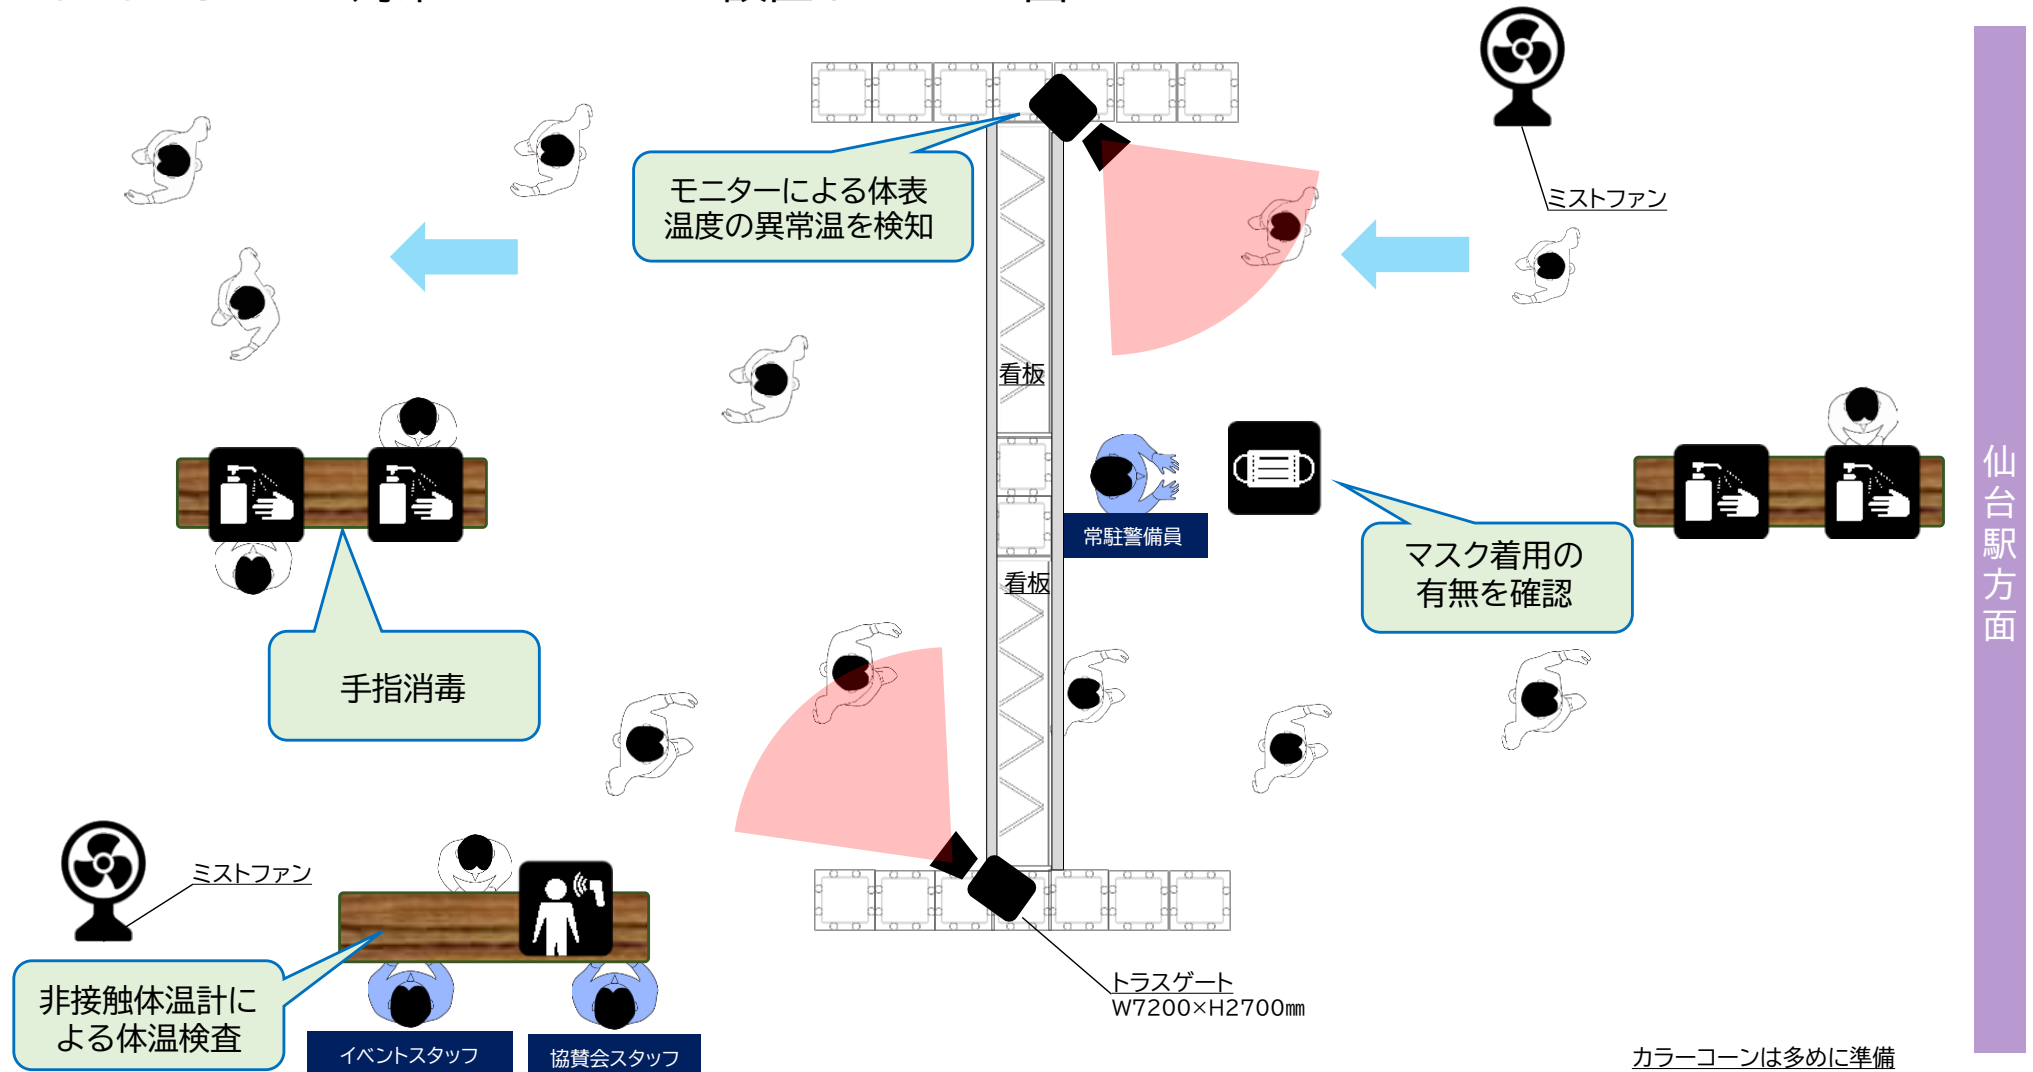

※37.5℃以上の発熱を確認した場合の対応※

体表温度異常発生(警備員)→涼しい環境で非接触体温計による温度検査(スタッフ) ①異常あり→その後の参加をご遠慮いただき、衛生管理責任者へ連絡
②異常なし→手指消毒へ案内

注意:サーマルカメラは、外気温によって実際の体温にズレが発生する可能性があるため、実施前にスタッフ等の体温で比較・調整のうえで誤差の修正を行うこと。